

Pionki, dnia 25-11-2020r.

**Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania - 2**

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-55/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Mobilny aparat RTG do zdjęć trzyłożkowych

**Treść pytań i odpowiedzi:**

Pytanie 1.

Punkty 8,9. Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą.

8. Wielkość dużego ogniska maks. 1,0 mm

9. Wielkość małego ogniska maks. 0,3 mm

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cyfrowego mobilnego aparatu RTG z lampą dwuogniskowa z wirującą anodą z ogniskami: duże ognisko: 1,2mm, małe ognisko: 0,6 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 2.


Punkt 39. Kodowanie danych dysku twardego (ochrona danych osobowych).

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania typu oprogramowanie COTS (Commercial Off The Shelf) - dostarczane w formie gotowego, zamkniętego produktu przez producenta na indywidualne życzenia użytkownika. Ponadto w ramach zabezpieczania systemu i danych na dysku przed niepowołanym dostępem i ochroną danych, oprogramowanie w aparacie rtg posiada możliwość indywidualnych konfiguracji i dostępu do danych na podstawie loginu i hasła oraz ustalenia tzw. przywilejów użytkowników. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia „automatycznego usuwania badań i obrazów”, które zostały wysłane do archiwum obrazkowego, czyli systemu PACS. Na podstawie wymienionych zabezpieczeń dane osobowe są prawidłowo chronione przez system i nie ma konieczności ich dodatkowego kodowania.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dane na dysku twardym były zabezpieczone poprzez zakodowanie danych na dyskach. Założenie to zostanie uznane za zrealizowane jeżeli dostarczany sprzęt lub oprogramowanie zakoduje dane znajdujące się na dyskach np. za pomocą sprzętowego modułu TPM lub oprogramowanie do szyfrowania danych na dysku.****Dodatkowo Zamawiający wymaga by dostęp do komputera i dostarczonego oprogramowania był zabezpieczony loginem i hasłem dla dowolnej liczby użytkowników.**

Pytanie 3.

Punkt 40. Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI wizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania, które dostosowuje obszar zainteresowania ROI i ustawienie m.in. jasności i kontrastu przy pomocy „suwaków” i przycisków jak przedstawia rysunek poniżej.

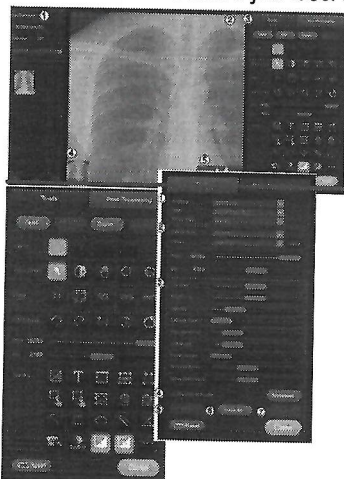

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4.

Punkt 43. Podłączenie oferowanego aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS. Pozyskanie licencji leży po stronie Wykonawcy.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie producentów i nazw systemów PACS/RIS.

Dopuszczenie naszego cyfrowego mobilnego aparatu rtg do zdjęć przyłóżkowych pozwoli Państwu dodatkowo skorzystać z możliwości kompatybilności i wymienności detektorów oraz pracy na tej samej konsoli technika z oprogramowaniem jak cyfrowy mobilny aparat rtg, który zostanie Państwu dostarczony w grudniu 2020 na podstawie umowy nr W/UMWMUF/ UM/NW/2150/2020 z dnia 16 listopada 2020 i załącznika nr 3 – „Wykaz podmiotów leczniczych – Miejsca Dostawy”, gdzie jedną ze stron umowy jest Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie uchwały nr 1521/170/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie realizacji zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Państwa pozytywna decyzja pozwoli nam złożyć ważną ofertę przedmiotową.

**Odpowiedź: Zamawiający posiada system:**

- PACS od firmy SYNEKTIK o nazwie ArPACS
- RIS od firmy COMARCH o nazwie CRID
- RIS od firmy COMARCH o nazwie RIS OPTIMED

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach  
im. Lecha i Marii Kaczyńskich  
- Pary Prezydenckiej  
*B. Dudek*  
Bernarda Dudek

.....  
podpis kierownika zamawiającego